

BAUREIHE 2000

TOTRAUMFREIE UND REPRÄSENTATIVE PROBENAHEME

PROBENAHEMEVENTIL

- DN4 BIS DN15, PN16/40
- MAX. ZUL. BETRIEBSTEMPERATUR: 180 °C
- BETÄTIGUNG: HANDRAD
- ANSCHLÜSSE: ZWEIKLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN
- REGULIERKEGEL
- SITZ-KEGEL-KOMBINATION AUSWECHSELBAR
- DACHMANSCHETTENPACKUNG AUS PTFE, FEDERBELASTET UND NACHSTELLBAR
- DURCHSTRÖMRICHTUNG FREI WÄHLBAR
- DRUCKTRAGENDE BAUTEILE AUS 1.4571

DAS PROBENAHEMEVENTIL IST EINFACH AUSTAUSCHBAR. EINE AUSSTATTUNG MIT **TOTMANNSCHALTUNG** UND **FALTENBALG** IST MÖGLICH.

➤ SCHUTZSCHRANK

B x H x T: 300 x 400 x 200 MM,
AUS ELEKTRISCH LEITFÄHIGEM GFK,
SICHTSCHEIBE IN DER TÜR AUS
EINSCHLEIBENSICHERHEITSGLAS,
DICHTUNGEN AUS EPDM

➤ FEDERBELASTETER HUBTISCH

FÜR 250 ML - GLASFLASCHE
(SCHOTT-DURAN, H = 138 MM)

➤ ÜBERFÜLLSICHERUNG


DURCH ÜBERLAUFLEITUNG

➤ ABSAUGUNG

SCHRANKINNENRAUM UND
FLASCHE ÜBER DIE KOPFAUFNAHME,
ANSCHLUSS: ZWEIKLEMMRING-
VERSCHRAUBUNG FÜR ROHR 12 MM

➤ DRAINAGESYSTEM

VON FLASCHENÜBERLAUF, AUFSTELLFLÄCHE
HUBTISCH UND SCHRANKBODEN,
FLANSCHANSCHLUSS DN15 NACH DIN 2633

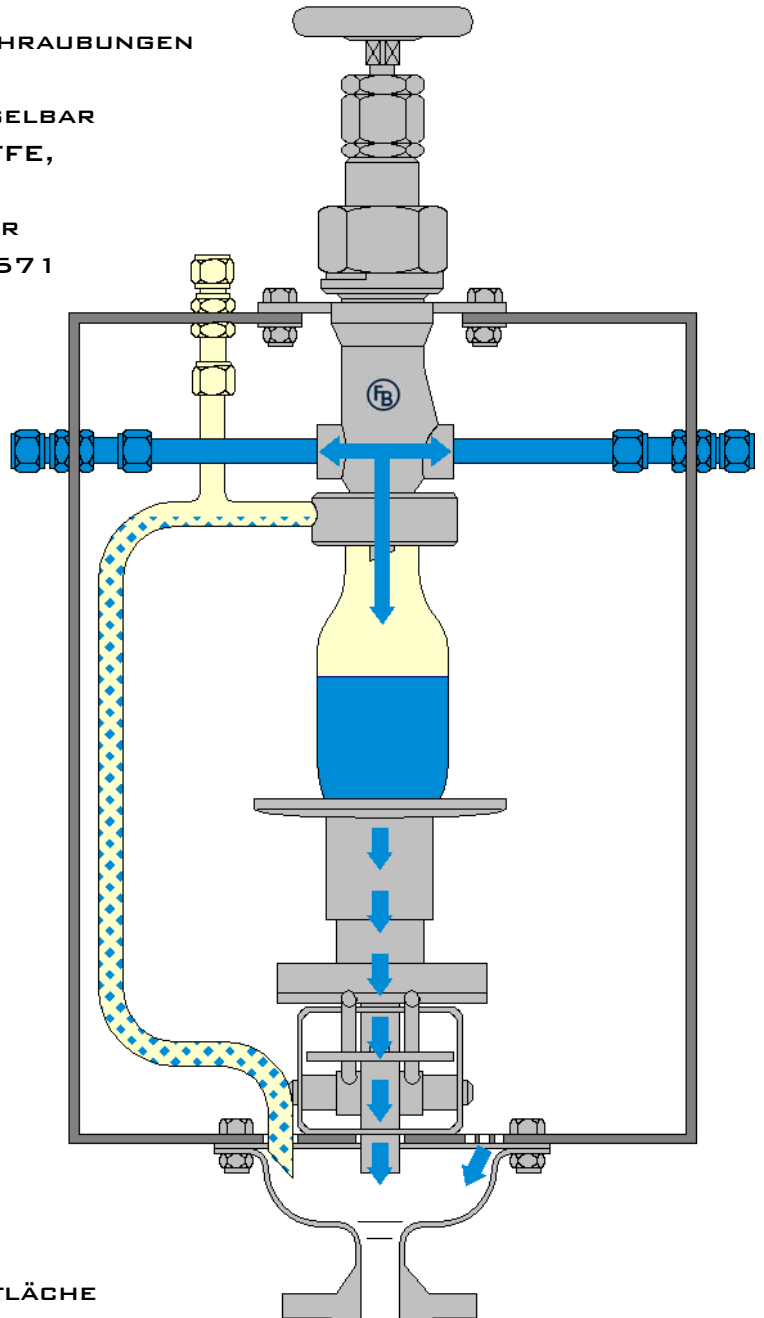

DAS BASISYSTEM 2000 ERFÜLLT ALLE MASSGEBLICHEN ANFORDERUNGEN AN EINE SICHERE PROBENAHEME UND FINDET EIN BREITES EINSAZTGEBIET. DOCH AUCH DIESEM SIND GRENZEN GESETZT. UNSERE ERFAHRUNG ZEIGT, DASS EIN OPTIMALES PROBENAHEMESYSTEM OFTMALS INDIVIDUELL AUF DAS ZU BEPROBENDE PRODUKT ANGEPASST WERDEN MUSS.

WIR INFORMIEREN SIE GERNE.

EMAIL-COVER R. Scholz GmbH

Scheiffartsweg 31 • D - 53919 Weilerswist • Tel. (02254) 5566 • Fax (02254) 4084 • verkauf@email-cover.de